
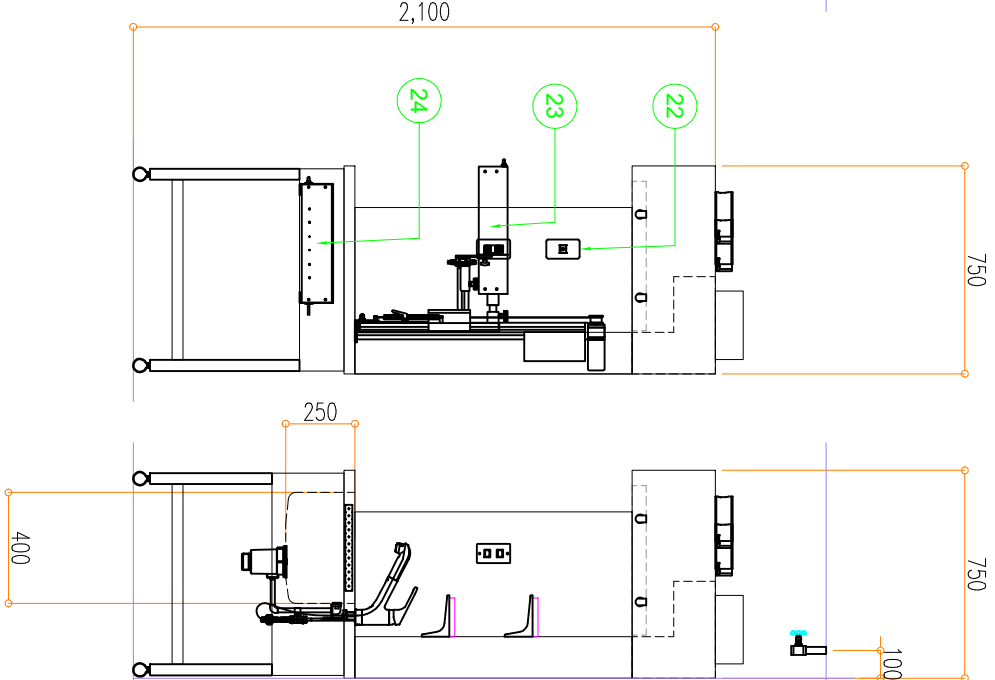
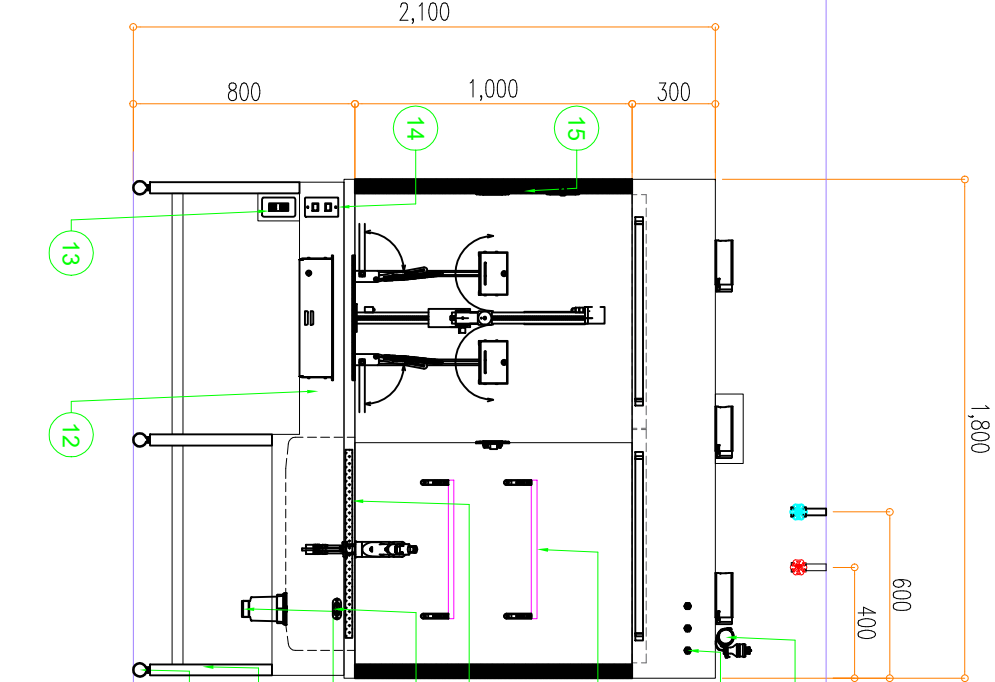
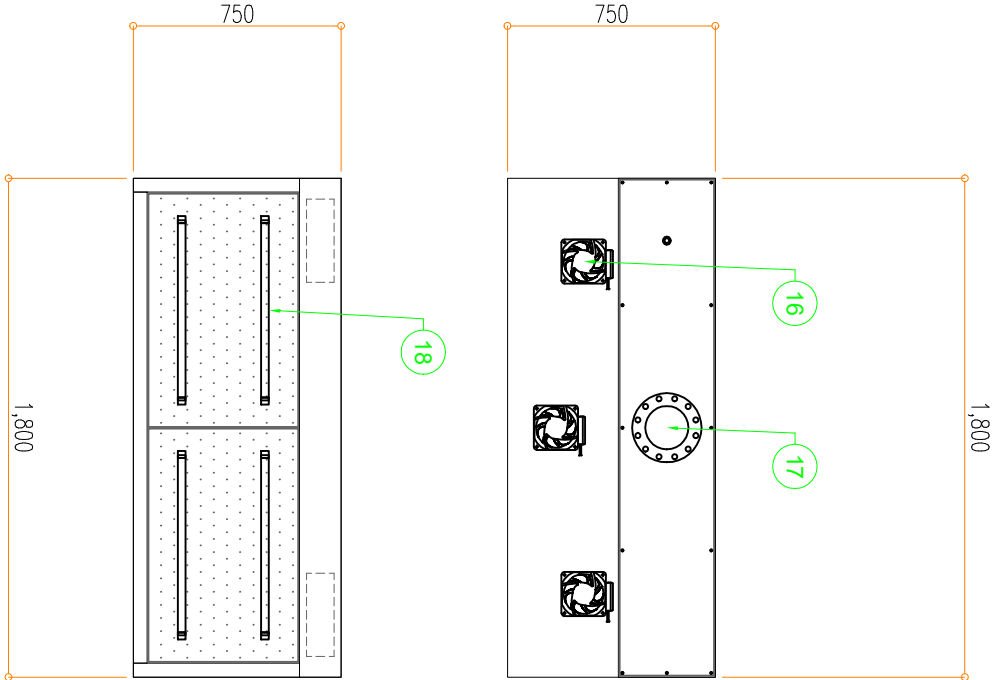
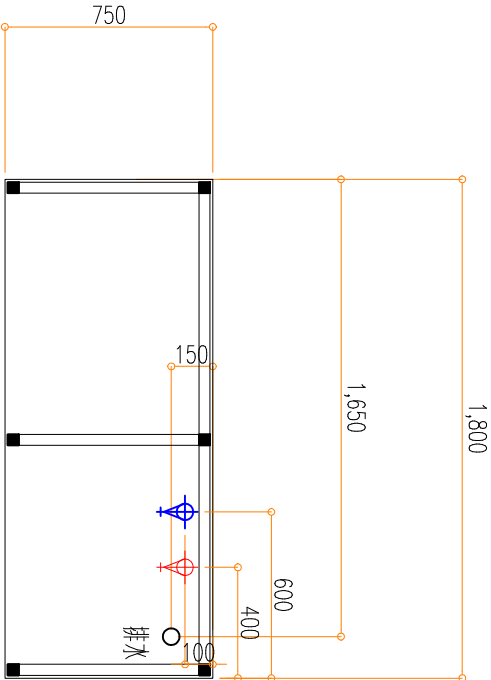
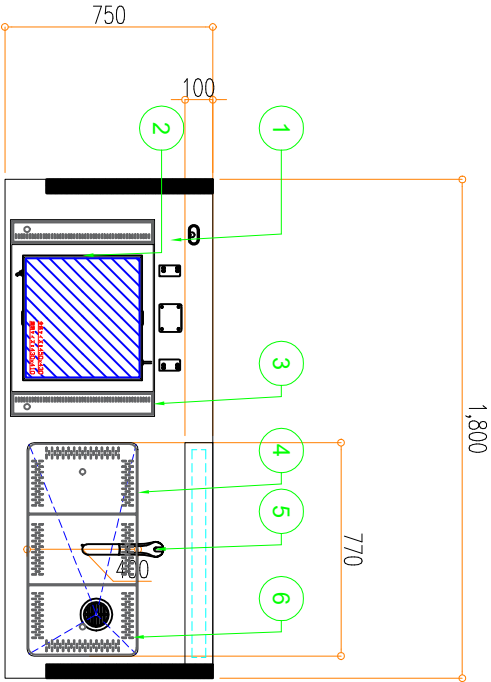


3F 標本整理・切出室

飲水・必要設備

給水：20A CH-100mm以下 GV止め 0.1~0.3Mpa  
給湯：20A CH-100mm以下 GV止め 0.1~0.3Mpa  
感染性排水：50A(VP) FL+100mm以上 1m7止め  
電源：AC100V/5A FL+2400mm以上 3P2W/1  
LAN：8種CAT6 FL+2400mm以上 7-7m余長2m  
排気ガス：250Φ 天井内VD止め CH-100mm  
風量：22M3/min(1320CMH) 静圧：約175Pa

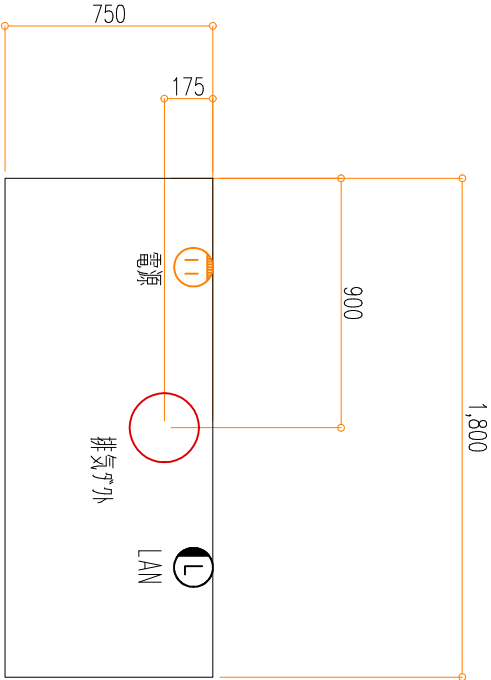

|    |            |   |  |  |
|----|------------|---|--|--|
| 25 | 機器本体側面化粧板  | 2 |  |  |
| 24 | ガス装置側面化粧板  | 2 |  |  |
| 23 | LANケーブル    | 1 |  |  |
| 22 | 可動棚        | 1 |  |  |
| 21 | ガス装置調整ガス   | 1 |  |  |
| 20 | 電源ガス       | 1 |  |  |
| 19 | LED照明灯     | 4 |  |  |
| 18 | 排気ガス接続口    | 1 |  |  |
| 17 | ガスガス       | 3 |  |  |
| 16 | 支柱         | 2 |  |  |
| 15 | ガス         | 2 |  |  |
| 14 | ガス         | 3 |  |  |
| 13 | 機器本体正面化粧板  | 1 |  |  |
| 12 | ガス装置       | 6 |  |  |
| 11 | 脚          | 6 |  |  |
| 10 | 排水口        | 1 |  |  |
| 9  | 小判型ガス      | 1 |  |  |
| 8  | 切り出し流し台用天板 | 3 |  |  |
| 7  | 切り出し流し台    | 1 |  |  |
| 6  | ガス装置用ガス    | 2 |  |  |
| 5  | ガス装置用ガス    | 1 |  |  |
| 4  | ガス装置用ガス    | 1 |  |  |
| 3  | ガス装置用ガス    | 1 |  |  |
| 2  | ガス装置用ガス    | 1 |  |  |
| 1  | ガス装置用ガス    | 1 |  |  |

寸法：W1800xD750xH800/2100mm  
台数：1台

第三角法

株式会社 加藤 製作所

作成者：野洲市立病院 御中  
担当：加藤 製作所  
DATE：2025/9/29  
縮尺：Scale=1:25  
図面名：ガス装置用ガス切出し流し台  
Model：KSEU-1875CPPL

図面番号